Medtronic

Sistema Guardian™ 4

Avvisi predittivi in terapia MDI

Medtronic presenta il nuovo sistema Guardian™ 4 – lo Smart CGM che fornisce avvisi predittivi personalizzabili per i pazienti in terapia MDI.

Il sistema Guardian™ 4 non richiede calibrazioni e sostituisce le glicemie capillari per le decisioni terapeutiche*.

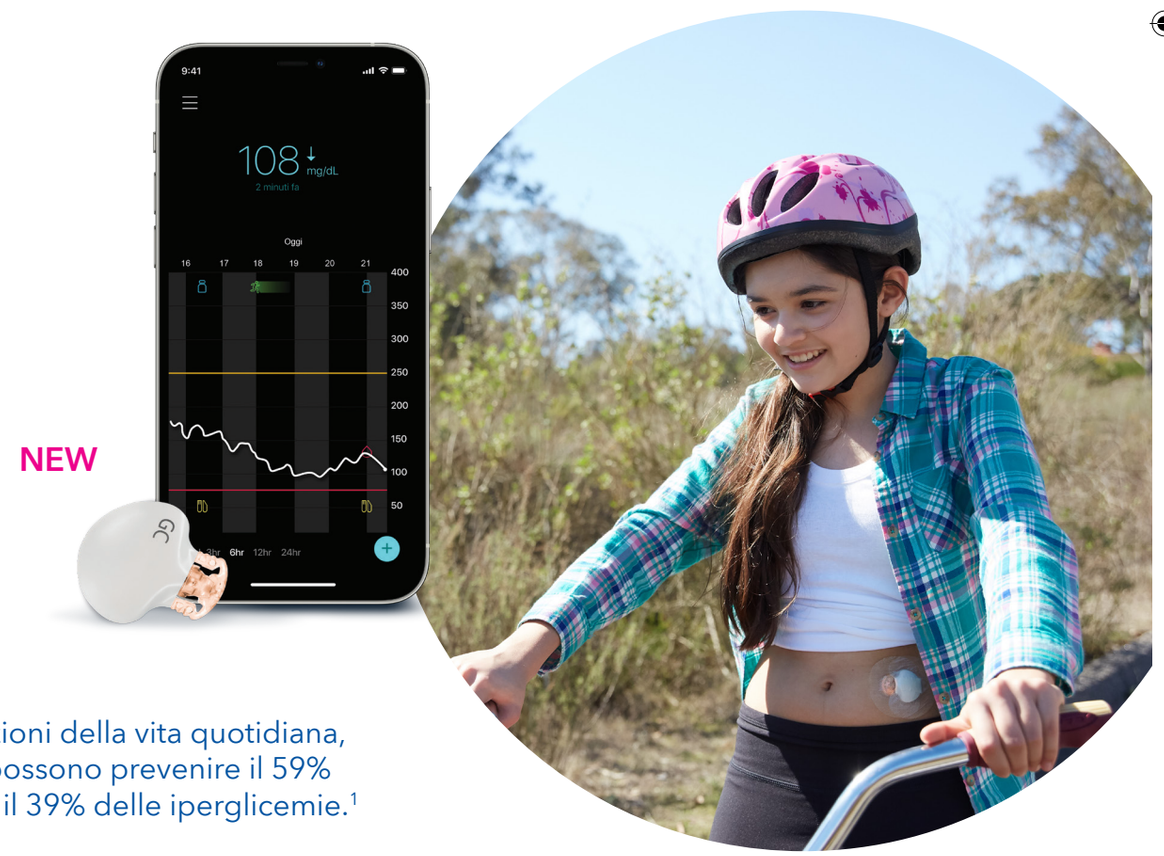

Nelle normali situazioni della vita quotidiana, gli avvisi predittivi possono prevenire il 59% delle ipoglicemie e il 39% delle iperglicemie.[1]

Il Sistema Guardian™ 4, quando sensore e trasmettitore sono collegati, è impermeabile** e resistente, adattandosi anche agli stili di vita più attivi.

Smart CGM con sistema Guardian™ 4 e i-Port Advance™

Un aiuto per ridurre l'impatto delle iniezioni e delle punture al dito per la gestione della terapia MDI

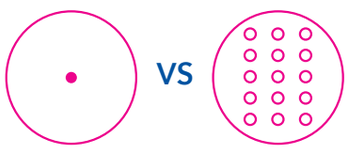

i-Port Advance Iniezioni standard

Sistema Guardian™ 4

- No calibrazioni*
- Sostituisce le glicemie capillari per decisioni terapeutiche*

i-Port Advance™

La porta di accesso sottocutanea che consente di diminuire le punture d'ago da 15 ad 1 ogni 3 giorni

	CODICE D'ORDINE	COMPOSIZIONE
	MMT-7920QW1 N. Repertorio: 2163265/R CND: Z1204011501	**MMT-7841QW1 Trasmettitore Guardian™ 4** N. Repertorio: 2163268/R CND: Z1204011501
		MMT-7512W One-Press Serter N. Repertorio: 2045759/R CND: Z1204021699
		1 caricatore per il trasmettitore Guardian™ 4 (MMT-7715), 2 tester (MMT-7736L)
	**MMT-7040QC1** N. Repertorio: 2164080/R CND: Z1204011501	**Confezione da 5 sensori Guardian™ 4** Include 10 cerotti Oval Tape per il fissaggio alla cute del sensore sottocutaneo.
	M000003A774 Il codice d'ordine non identifica un prodotto fisico, ma comprende i dispositivi descritti in tabella alla voce composizione	**Bundle contenente una confezione di 5 sensori Guardian ™ 4 (MMT-7040QC1) ed una confezione di 10 i-Port Advance™ (MMT-100)**

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
1. Abraham SB, et al. Improved Real-World Glycemic Control With Continuous Glucose Monitoring System Predictive Alerts. Journal of Diabetes Science and Technology 2021; 15(1):91–97

* Se i valori rilevati dal sensore non corrispondono alle aspettative, effettuare una glicemia capillare mediante glucometro per prendere decisioni terapeutiche. Fare riferimento alla Guida per l'utente del sistema

**Resistenza all'acqua del sistema trasmettitore e sensore collegati: IP48. Protezione dagli effetti dell'immersione in acqua fino a 2,4 m per 30 minuti consecutivi;

Medtronic

Italia
Medtronic Italia S.p.a
Via Varesina, 162
IT - 20156 Milano (MI)
Tel. +39 02 24 13 7261
Fax. +39 02 24 13 8210

pro.medtronic-diabete.it

Nonostante le ragionevoli precauzioni prese nella redazione della presente brochure, Medtronic non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni, né per gli usi dei materiali ivi contenuti o le decisioni basate su tali usi. Il presente documento non contiene tutte le informazioni necessarie per una cura e un trattamento completo del paziente. Per tali ragioni, nessun soggetto può affidarsi alle informazioni ivi presentate per l'elaborazione di un programma di trattamento completo o per la terapia del paziente. Non vengono fornite garanzie, espresse o implicite, per quanto riguarda i contenuti del presente documento o la relativa applicabilità a pazienti o circostanze specifiche. Per un elenco completo di indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni dei dispositivi citati, si prega di consultare le istruzioni per l'uso dei singoli dispositivi. Medtronic non può essere ritenuta responsabile in alcun modo per danni dovuti all'utilizzo o alla interpretazione non corretta dei contenuti della presente brochure.

Tutti i diritti riservati. il logo Medtronic e MiniMed™ sono marchi commerciali di Medtronic™. I marchi di terzi sono marchi commerciali appartenenti ai loro rispettivi proprietari. Tutti gli altri marchi sono marchi commerciali di proprietà di un'azienda del gruppo Medtronic.

UC202208904 IT